




M I S U R A &
AUTOMAZIONE

Misura di pressione Gas e Strumenti di calibrazione

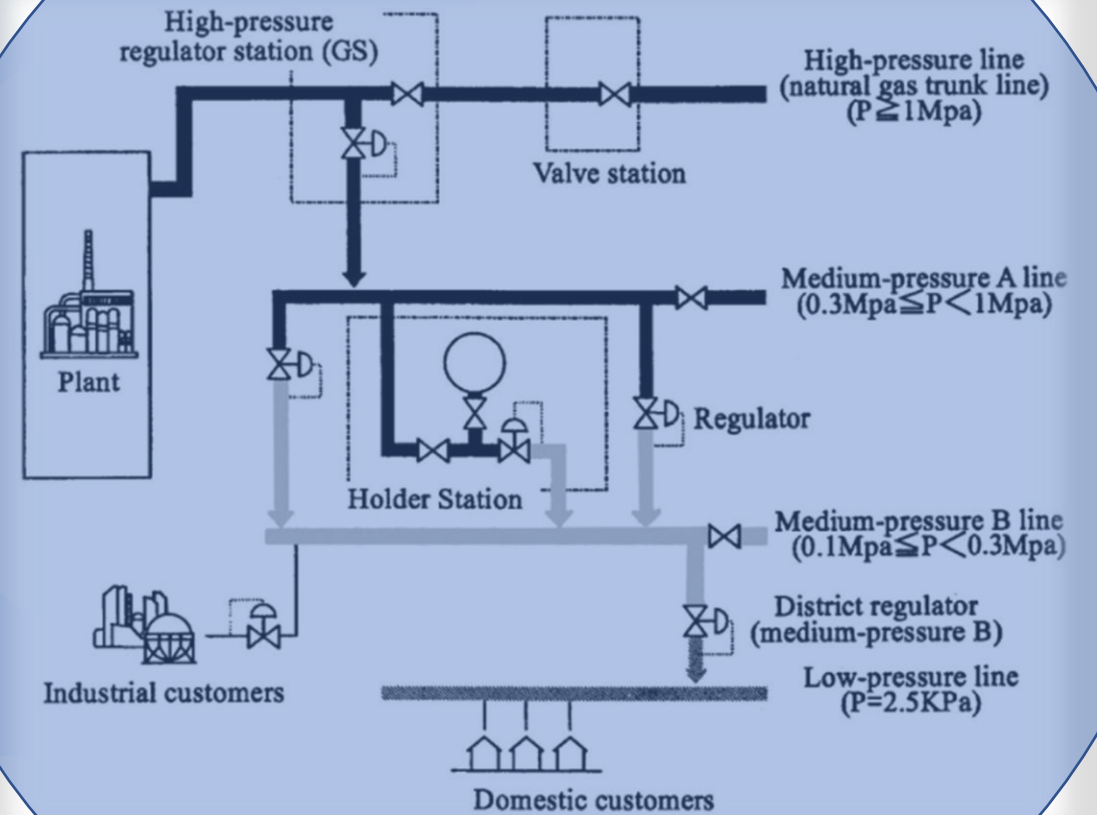

MISURA
AUTOMAZIONE

Trasmettitori di Pressione – ATEX - High End Accuracy

UNIK 5000

Pressure Sensing Platform




Pressure range from 70 mbar (1 psi) to 700 bar (10000 psi)

- **Accuracy to $\pm 0.04\%$ Full Scale (FS)** Best Straight Line (BSL)
- Stainless Steel
- Frequency response to 3.5 kHz
- High over pressure capability
- Hazardous Area
- mV, mA, voltage and configurable voltage outputs
- Multiple electrical and pressure connector options
- **Temperature ranges from -40 to $+125^{\circ}\text{C}$ (-67 to $+257^{\circ}\text{F}$)**



Ex I M1 Ex ia I Ma ($-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80^{\circ}\text{C}$)

Ex II 1G Ex ia IIC T5 Ga ($-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80^{\circ}\text{C}$)

Ex II 1D Ex ta IIIC T111°C Da IP64 ($-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80^{\circ}\text{C}$)

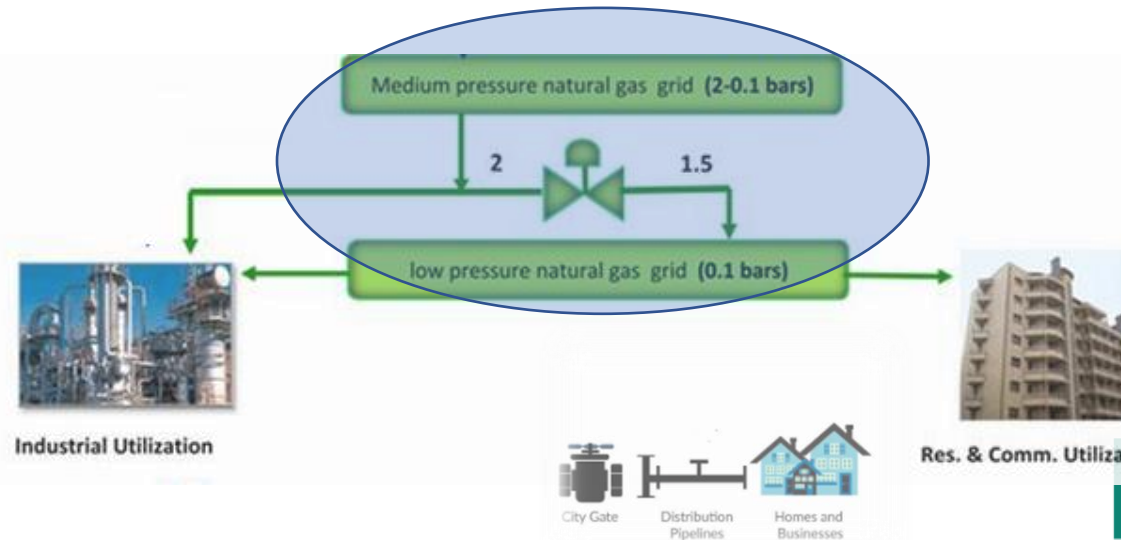

Innovativo sistema modulare

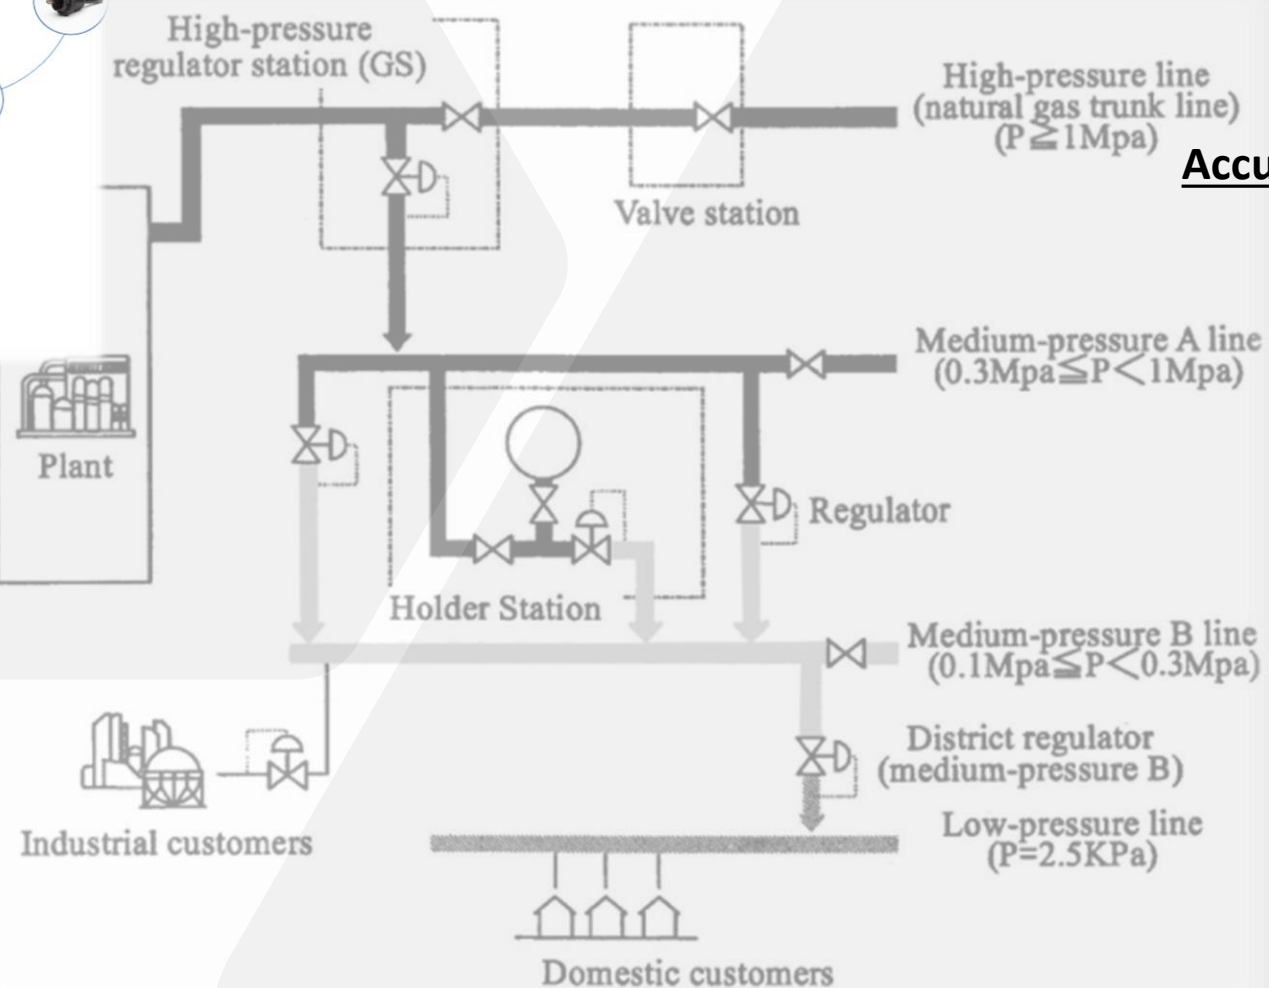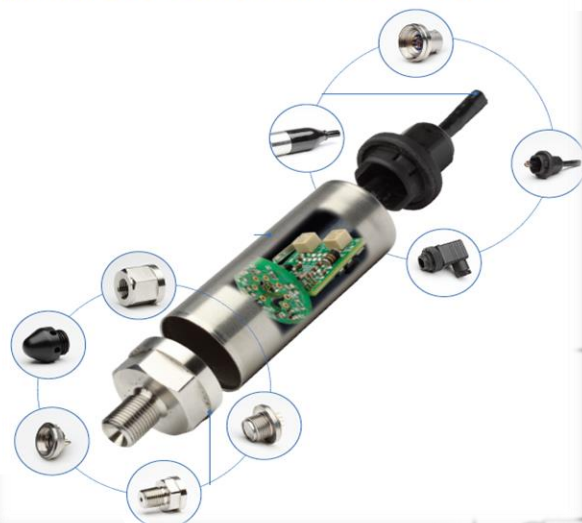


Pressure range from 70 mbar

Accuracy to $\pm 0.04\%$ Full Scale



Piattaforme di Calibrazione portatile Multifunzione

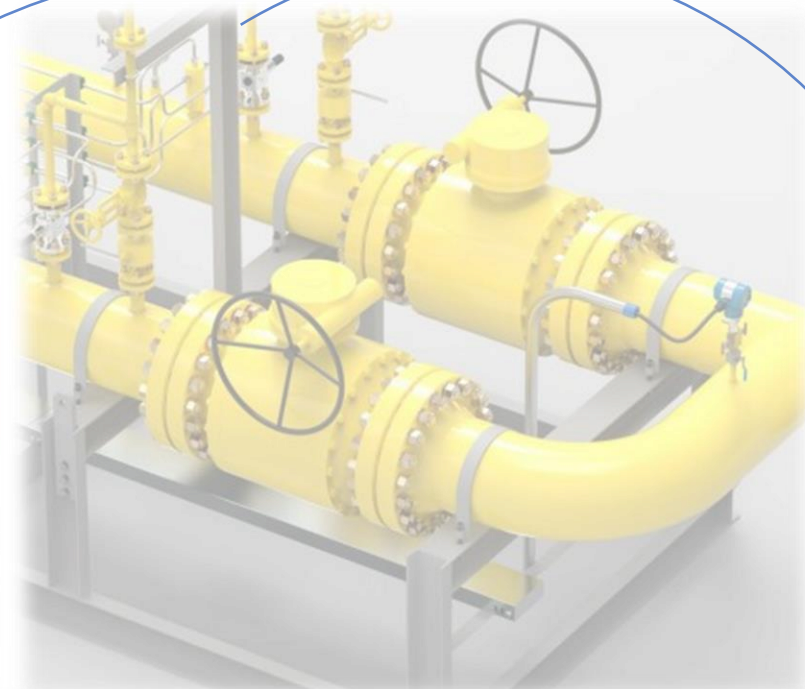



Indicatori e Manometri - Test Tools -Kit



Valigia Kit :

- Manometro Portatile con sensore interno accuracy 0.05%FS
- Sensore di pressione Remoto opzionale
- Misura di Temperatura

Soluzioni di Misura Custom - Barometro / Temperatura / Umidità'

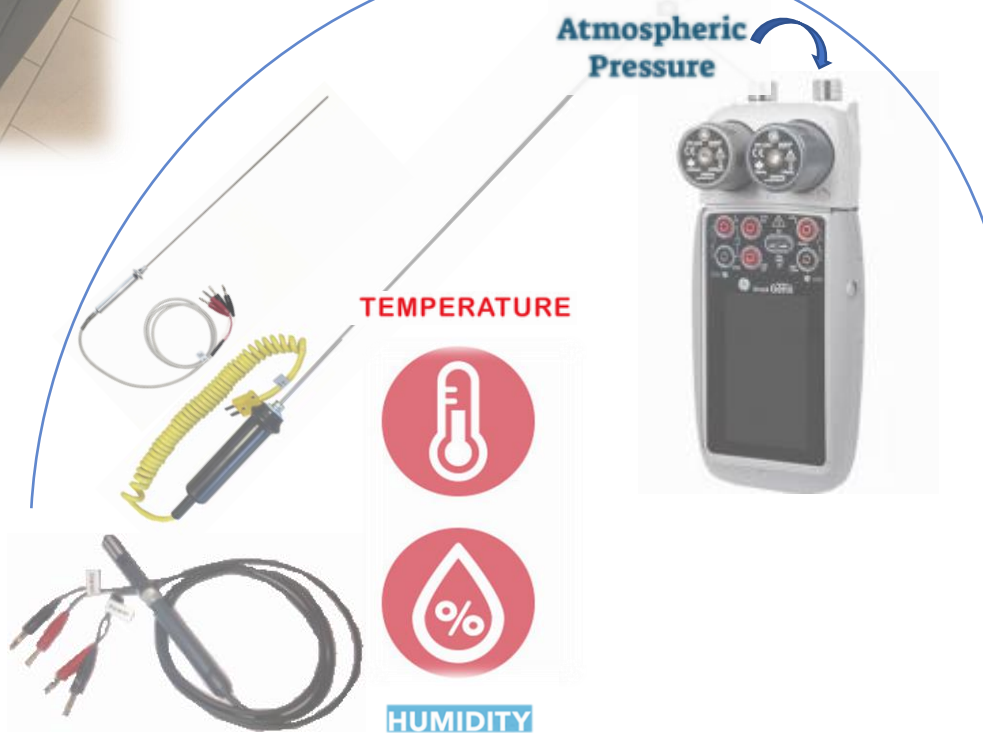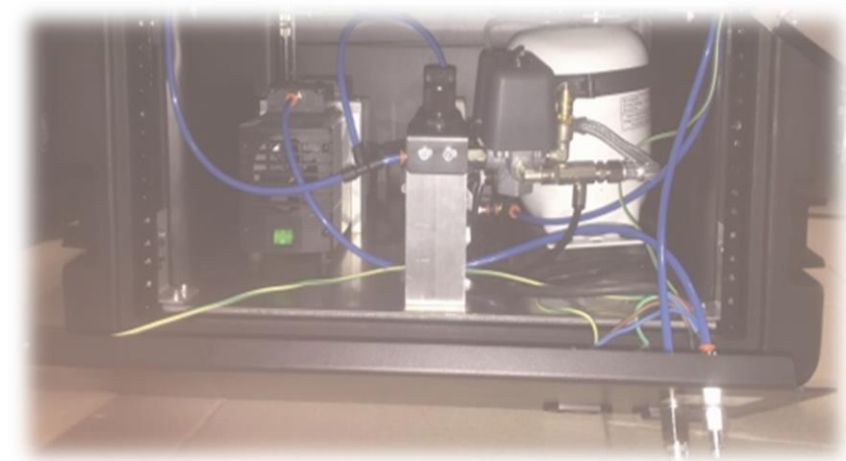

Servizio di Certificazione Strumenti / Riparazione



Myepc Total Care Assistance


ENTRA

EMAIL

PASSWORD

LOGIN


Reiscrivi | resetta la password




RICEVIMENTO RICHIESTA
Indica che la richiesta di servizio è stata inviata correttamente e ricevuta dal nostro centro assistenza che provvederà ad inviare offerta e successivamente i documenti necessari alla spedizione.




RICEVIMENTO STRUMENTO
Questo stato conferma il ricevimento dello strumento presso il laboratorio.




LAVORAZIONE PRESSO LABORATORIO
Questo stato conferma l'inizio della lavorazione.



CONCLUSIONE LAVORAZIONE
Questo stato indica che la lavorazione presso il laboratorio è conclusa.



ARRETRATI A PAGARE



ANNULLATO



Academy - Formazione

